



**EN** Insert four AA size alkaline batteries in the battery compartment in the back of the AED Trainer 3.

**FR** Insérez quatre piles alcalines format AA dans le compartiment de la batterie situé à l'arrière du défibrillateur de formation AED Trainer 3.

**DE** Vier AA-Alkali-Batterien in das Akku-/Batteriefach auf der Rückseite des AED Trainer 3 einlegen.

**ES** Inserte cuatro pilas alcalinas AA en su compartimento ubicado en la parte posterior del AED Trainer 3.

**IT** AA nel vano batterie posto sul retro del defibrillatore AED Trainer 3.

**PT** Insira quatro pilhas alcalinas AA no compartimento da bateria na parte de trás do Simulador de treinamento AED Trainer 3.



**EN** Press and hold both buttons for 6 seconds. Release both buttons, then press the lightning bolt button to scroll through list of languages until the desired language is announced. To save the language selection, turn off the AED Trainer 3 by pressing the power button. The language will be active the next time you turn on the AED Trainer 3.

**FR** Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 6 secondes. Relâchez les deux boutons, puis appuyez sur le bouton éclair pour faire défiler la liste des langues jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée. Pour enregistrer la sélection de la langue, éteignez le défibrillateur de formation AED Trainer 3 en appuyant sur le bouton arrêt. La langue choisie sera active à la prochaine mise sous tension du AED Trainer 3.

**DE** Beide Tasten 6 Sekunden lang gedrückt halten. Beide Tasten loslassen. Dann die Taste Blitz drücken, um durch die Liste der verfügbaren Sprachen zu blättern, bis die gewünschte Sprache ausgegeben wird. Zum Speichern der ausgewählten Spracheinstellung den AED Trainer 3 durch Drücken der Taste Ausschalten. Beim nächsten Einschalten des AED Trainer 3 ist die Spracheinstellung aktiviert.

**ES** Mantenga pulsados los botones durante 6 segundos. Suelte los botones y, a continuación, pulse el botón rayo para desplazarse por la lista de idiomas hasta que aparezca el idioma deseado. Para guardar el idioma seleccionado, apague el AED Trainer 3 pulsando el botón apagado. El idioma estará activo la próxima vez que encienda el AED Trainer 3.

**IT** Tenere premuti entrambi i pulsanti per 6 secondi. Dopo averli rilasciati, premere il pulsante fulmine per scorrere l'elenco delle lingue disponibili e tenerlo premuto fino a quando non si raggiunge la lingua desiderata. Per salvare la lingua selezionata, spegnere l'AED Trainer 3 premendo il pulsante spento. Alla successiva accensione, il sistema utilizzerà le impostazioni della lingua salvate.

**PT** Pressione e segure os dois botões por 6 segundos. Solte os dois botões e depois pressione o botão raio para rolar pela lista de idiomas até que o idioma desejado seja indicado. Para salvar a seleção de idioma, desligue o Simulador de treinamento AED Trainer 3 pressionando o botão desligado. Na próxima vez que o Simulador de treinamento AED Trainer 3 for ligado, o idioma estará ativo.



**EN** Apply "TRAINING ONLY" sticker for the selected language.


**FR** Appliquez l'étiquette "POUR LA FORMATION UNIQUEMENT" de la langue sélectionnée.

**DE** German Aufkleber „NUR SCHULUNG“ in der ausgewählten Sprache anbringen.

**ES** Coloque la etiqueta adhesiva "SÓLO ENTRENAMIENTO" que corresponda al idioma seleccionado.

**IT** Cambiare l'etichetta "SOLO PER ADDESTRAMENTO" applicando quella corrispondente alla lingua impostata.

**PT** Cole o adesivo "SOMENTE PARA TREINAMENTO" no idioma selecionado.

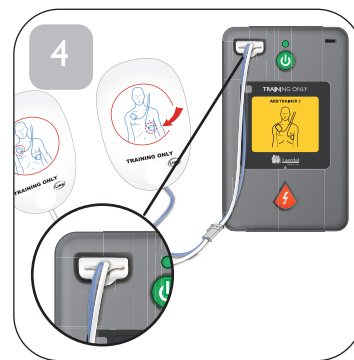

**EN** Plug the Training Pads connector into the connector port on the front of the AED Trainer 3. Prepare the manikin to accept pad placement as appropriate. You are now ready to start training.


**FR** Branchez le connecteur des électrodes d'entraînement dans le port de connexion à l'avant de l'AED Trainer 3. Préparez le mannequin pour un positionnement adéquat des électrodes. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre formation.

**DE** Stecken Sie die Stecker der Trainingspads in den Anschluss an der Vorderseite des AED-Trainers 3. Übungspuppe für die Pads-Platzierung vorbereiten. Die Schulung kann nun beginnen.

**ES** Enchufe el conector de los electrodos de entrenamiento en el puerto del conector ubicado en la parte frontal del AED Trainer 3. Prepare el maniquí para que se puedan colocar los electrodos correctamente. Ya está preparado para comenzar con el entrenamiento.

**IT** Collegare il connettore degli elettrodi per addestramento all'apposita presa posta sul lato anteriore dell'AED Trainer 3. Predisporre il manichino per l'applicazione degli elettrodi secondo le istruzioni fornite. A questo punto l'addestramento può avere inizio.

**PT** Encaixe os conectores das pás de treinamento na porta do conector localizada na frente do AED Trainer 3. Prepare o manequim para aceitar o posicionamento dos electrodos conforme necessário. A partir desse momento, você estará pronto para começar o treinamento.

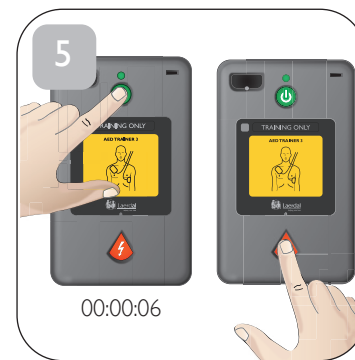

**EN** To select a different scenario, press and hold the power button for 6 seconds. Press the lightning bolt button as directed to scroll through the scenarios until the desired scenario is announced. To save the selected scenario, turn off the AED Trainer 3 by pressing the power button. The scenario will be active the next time you turn on the AED Trainer 3.

**FR** Pour sélectionner un scénario différent, appuyez sur le bouton arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. Appuyez sur le bouton éclair comme indiqué par l'appareil, afin de faire défiler les scénarios jusqu'à ce que le scénario souhaité soit affiché. Pour enregistrer le scénario sélectionné, éteignez le défibrillateur de formation AED Trainer 3 en appuyant sur le bouton arrêt. Le scénario choisi sera actif à la prochaine mise sous tension du simulateur AED Trainer 3.


**DE** Zum Auswählen eines anderen Szenarios die Taste 6 Sekunden lang gedrückt halten. Nach Anweisung Blitz drücken, um durch die verfügbaren Szenarien zu blättern, bis das gewünschte Szenario ausgegeben wird. Zum Speichern des ausgewählten Szenarios den AED Trainer 3 durch Drücken der Taste Ausschalten. Beim nächsten Einschalten des AED Trainer 3 ist das Szenario aktiviert.

**ES** Para seleccionar un escenario diferente, mantenga pulsado el botón apagado durante 6 segundos. Pulse el botón rayo para desplazarse por los escenarios hasta que aparezca el que desee. Para guardar el escenario seleccionado, apague el AED Trainer 3 pulsando el botón apagado. El escenario estará activo la próxima vez que encienda el AED Trainer 3.

**IT** Per scegliere uno scenario diverso da quello impostato, tenere premuto il pulsante spento per 6 secondi. Premere il pulsante fulmine per scorrere i vari scenari fino a raggiungere quello desiderato. Per salvare lo scenario selezionato, spegnere l'AED Trainer 3 premendo il pulsante spento. Alla successiva accensione, il sistema utilizzerà le impostazioni dello scenario salvate.

**PT** Para seleccionar outro ambiente de treinamento, pressione e segure o botão desligado por 6 segundos. Pressione o botão raio conforme orientado para rolar pelos ambientes, até chegar ao ambiente desejado. Para salvar o ambiente selecionado, desligue o Simulador de treinamento AED Trainer 3 pressionando o botão desligado. Na próxima vez que o Simulador de treinamento AED Trainer 3 for ligado, o ambiente estará ativo.

## Scenario codes

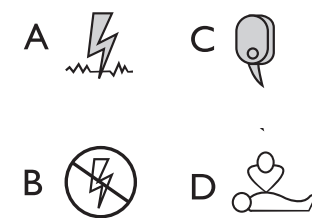

## EN Scenario codes

- A = Shockable Rhythm
- B = Non-shockable Rhythm
- C = Pads problem detected
- D = CPR First protocol initiated

## FR Codes des scénarios

- A = Rythme nécessitant un choc
- B = Rythme ne nécessitant pas de choc
- C = Problème d'électrodes détecté
- D = Protocole RCP initiale activé

## DE Scenario-Codes

- A = Defibrillierbarer Rhythmus
- B = Nicht-defibrillierbarer Rhythmus
- C = Problem an den Pads fest gestellt
- D = Zuerst HLW"-Protokoll gestartet

## ES Códigos de los escenarios

- A = Ritmo susceptible de choque
- B = Ritmo no susceptible de choque
- C = Problema detectado en los electrodos
- D = Protocolo RCP primero iniciado


## IT Codici degli scenari

- A = Ritmo defibrillabile
- B = Ritmo non defibrillabile
- C = Anomalia rilevata negli elettrodi
- D = Protocollo RCP iniziale avviato

## PT Códigos de ambientes

- A = Ritmo passível de choque
- B = Ritmo não passível de choque
- C = Detectado problema com os eletrodos
- D = Protocolo Primeiro, RCP iniciado

## AED Trainer 3 Scenarios

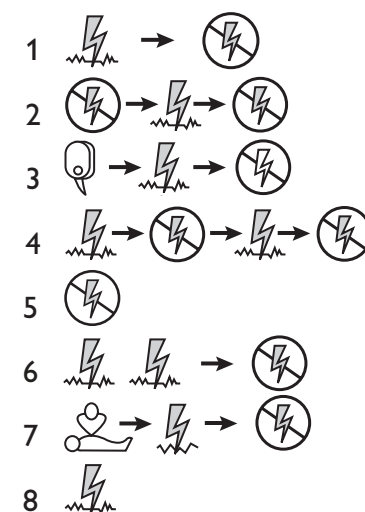

Laerdal Medical AS,  
P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30,  
4002 Stavanger, Norway

Distributed in the US  
by Laerdal Medical  
Corporation Wappingers Falls,  
NY 12590-8840

Distributed in Canada  
by Laerdal Medical  
Canada Ltd. Toronto,  
Ontario M1V 4C3

Made in China



© LAERDAL MEDICAL AS 2020. All rights reserved.  
Laerdal 20-03295 Rev D

# AED Trainer 3

## Quick Setup Guide

- EN
- FR
- DE
- ES
- IT
- PT

