

AEROresc® - EASY Collar Mini
Klasični model AEROresc® - EASY Collar Mini
Klasični model AEROresc® - EASY Collar Mini

1. Modellen
REF: HMT11-EC-K
Produktbeskrivelse: AEROresc® - EASY Collar Mini, justerbart nakkekrage for spedbørn, børn og små voksne, blå farge
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)
Tuotteen kuvaus: AEROresc® - EASY Collar Adult, justerbart nakkekrage for voksne, gul färg
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)

2. Bruksformål og beskrivelse
AEROresc® - Easy Collar er en effektiv, stabil nakkekrage som brukes for immobilisering av nakkesøylen. Den benyttes som redningsutrustninger under transport, rutinemessig pasientbehandling og ved enlytting av pasienten som et hjelpemiddel til å opprettholde en nøytral stilling av cervikalsøylen og skal forhindre bevegelser til siden, forover og bakover, samt forlengelse av cervikalsøylen.
AEROresc® - Easy Collar Adult kan tilpasses 16 størrelser: AEROresc® - Easy Collar Mini kan tilpasses 12 størrelser. Begge modeller kan egnet for bruk i CT og MRI.

3. Prinsipler for immobilisering
Som et forebyggende tiltak skal ryggens skade på nakkesøylen og ryggmargen holdes pasientens hode og kropp i en „nøytral stilling“, hodeløst eller ikke bevegelse seg fremover, bakover eller sidelengs. Den nøytrale stillingen forhindrer at skadede ryggvirvler eller fremmedlegemer penetrerer eller skader ryggmargen. I tillegg hindrer den nøytrale posisjonen lunge og/eller kompresjon av ryggmargen samt fysiske og/eller iskemiske skader.

Advarsel
Nakkekragen må brukes bare etter instruksjon av lege og helsepersonell (f.eks. lege eller personale fra redaktøret) som har fått opplæring i bruk av produktet. Feil bruk av nakkekragen kan føre til virgde skader.
Nakkekragen utgår en del av et behollet immobiliserings apparat. Det er viktig å etterholde bar opplæring og praksis i brukten av produktet og har lest og forstått hele bruksanvisningen for nakkekragen brukes.

Alle instruksjoner er å anse som en veiledning og er ikke foranket på å definere medisinsk praksis.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

2. Når hode og nakke er stabilisert for hånd, bør en annen hjelper sette nakkekragen på pasienten. Som forsikret redningsmed, må størrelsen på nakkekragen tilpasses på forhånd. Den skal passe nakkekragen må ikke føre til overanstrengelse i pasientens nakke eller cervikalsøylen.

3. Mål avstanden mellom et tenk plan som går horisontalt rett under haken på pasienten, og et andre plan som går horisontalt rett over skuldrene (Figur 2).

4. Overfør den beregnede fingeravstanden på punkt 4.2, som vist på Figur 3, til målelinjen på nakkekragen og les av den korrekte størrelsen for nakkekragen på målelinjen (Figur 3).

5. Instillering av størrelse: AEROresc® - Easy Collar Adult er forholdsinstillingsstørrelse 1 „J“ „Neckless“ / AEROresc® - Easy Collar Mini er forholdsinstillingsstørrelse 1 „Infant“. Hvis det er behov for å ikke størrelsen på nakkekragen, leire sikkerhetstett ved å trekke i låseknappen (Figur 4).

6. Still inn riktig størrelse: Størrelsen „Neckless“ og „Tall“ på AEROresc® - Easy Collar Adult kan tilpasses i 16 løseinn. Størrelsen „Infant“ og „Small Adult“ på AEROresc® - Easy Collar Mini kan tilpasses 12 løseinn. Trekk nakkekragen fra hverandre til tillast størrelsen som vises i vinduet, stemmer med tallstørrelsen målt i punkt 4.4 (Figur 5).

7. Lås sikkerhetstett ved å trykke begge låseknappene ned (Figur 6).

8. Sett på nakkekragen

9. For å sette nakkekragen riktig på, trenes det 2 personer. Den første hjelperen skal opprettholde stabiliseringen og den andre posisjonen av hode og hals ved å gripe og holde i hode og nakke ved sprangene (Figur 1).

10. Den andre hjelperen skal styke den fremre delen av nakkekragen langs pasientens bryst og plassere haleskatten. Nakkekragen i sin helhet skal settes på eller påføres sammenhengende ned til pasientens skuldre og brysten (Figur 7). Pasientens hake skal ligge i nøytral stilling på haleskatten (Figur 7).

11. Mens den fremre delen av nakkekragen holdes i posisjon, legg nakkekragens bakre del omkring pasientens hode og nakke. Fest til slutt den bakre delen av nakkekragen til den fremre delen ved hjelp av bollen (Figur 8). Pass på å ikke berøre den bollen eller parallelt med bollen på et annet punkt (Figur 8).

12. Tilpass bollen etter behov. Det bør være å hode nakkekragen i haken på den fremre delen og etterstørrelsen bollen (Figur 9).



Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

6.1 Når pasienten ligger på ryggen, sjikk nakkekragen direkte under pasientens nakke.
6.2 Når pasienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke.

7. Garanti
1 år garanti i henhold til våre betingelser:
- gir en material- og produksjonsfeil på kjøpstid.
- gir en feil i forbindelse med kjøpsvillingen.

Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

2. Garanti
1 år garanti i henhold til våre garantibestemmelser:
- er gjeldende for materiale- eller fabrikkfeilstøtte på kabinettet.
- er kun gjeldende i forbindelse med fremrensning av kabinettvillingen.

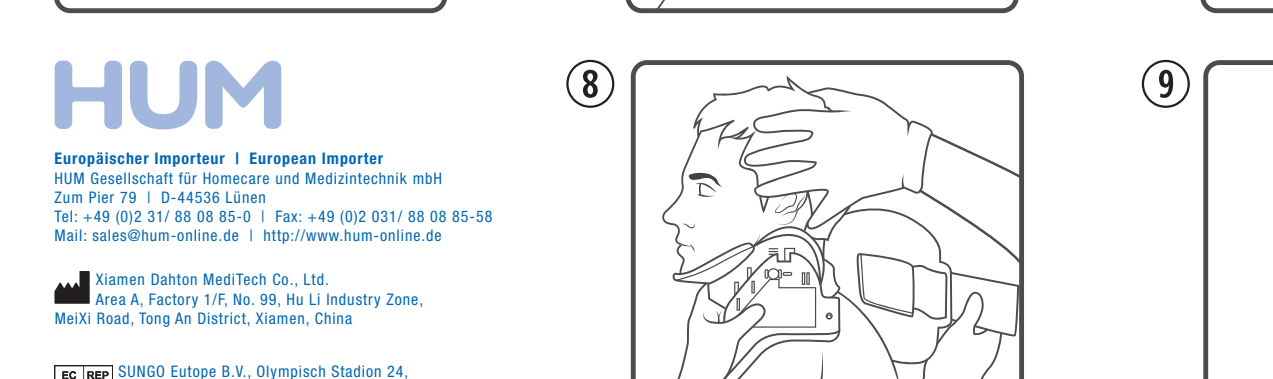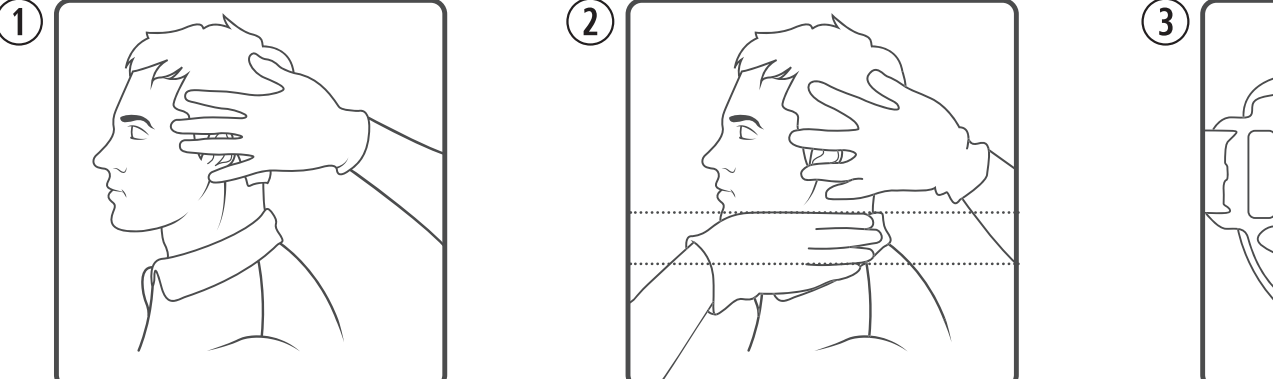

AEROresc® - EASY Collar Mini
Klasični model AEROresc® - EASY Collar Mini
Klasični model AEROresc® - EASY Collar Mini

1. Modellen
REF: HMT11-EC-K
Produktbeskrivelse: AEROresc® - EASY Collar Mini, justerbart nakkekrage til spedbørn, børn og teenagere, komer i blå
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)
Tuotteen kuvaus: AEROresc® - EASY Collar Adult, justerbart nakkekrage til voksne, kormer i gul färg
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)

2. Anvendelse og beskrivelse
AEROresc® - Easy Collar er en effektiv, stabil cervikal linse. Målet er å posisjonere nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

3. Prinsipler for immobilisering
Som et forebyggende tiltak skal ryggens skade på nakkesøyle og ryggmargen holdes pasientens hode og kropp i en „nøytral stilling“, hodeløst eller ikke bevegelse seg fremover, bakover eller sidelengs. Den nøytrale stillingen forhindrer at skadede ryggvirvler eller fremmedlegemer penetrerer eller skader ryggmargen. I tillegg hindrer den nøytrale posisjonen lunge og/eller kompresjon av ryggmargen samt fysiske og/eller iskemiske skader.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

2. Når hode og nakke er stabilisert for hånd, bør en annen hjelper sette nakkekragen på pasienten. Som forsikret redningsmed, må størrelsen på nakkekragen tilpasses på forhånd. Den skal passe nakkekragen må ikke føre til overanstrengelse i pasientens nakke eller cervikalsøylen.

3. Mål avstanden mellom et tenk plan som går horisontalt rett under haken på pasienten, og et andre plan som går horisontalt rett over skuldrene (Figur 2).

4. Overfør den beregnede fingeravstanden på punkt 4.2, som vist på Figur 3, til målelinjen på nakkekragen og les av den korrekte størrelsen for nakkekragen på målelinjen (Figur 3).

5. Instillering av størrelse: AEROresc® - Easy Collar Adult er forholdsinstillingsstørrelse 1 „J“ „Neckless“ / AEROresc® - Easy Collar Mini er forholdsinstillingsstørrelse 1 „Infant“. Hvis det er behov for å ikke størrelsen på nakkekragen, leire sikkerhetstett ved å trekke i låseknappen (Figur 4).

6. Still inn riktig størrelse: Størrelsen „Neckless“ og „Tall“ på AEROresc® - Easy Collar Adult kan tilpasses i 16 løseinn. Størrelsen „Infant“ og „Small Adult“ på AEROresc® - Easy Collar Mini kan tilpasses 12 løseinn. Trekk nakkekragen fra hverandre til tillast størrelsen som vises i vinduet, stemmer med tallstørrelsen målt i punkt 4.4 (Figur 5).

7. Lås sikkerhetstett ved å trykke begge låseknappene ned (Figur 6).

8. Sett på nakkekragen

9. For å sette nakkekragen riktig på, trenes det 2 personer. Den første hjelperen skal opprettholde stabiliseringen og den andre posisjonen av hode og hals ved å gripe og holde i hode og nakke ved sprangene (Figur 1).

10. Den andre hjelperen skal styke den fremre delen av nakkekragen langs pasientens bryst og plassere haleskatten. Nakkekragen i sin helhet skal settes på eller påføres sammenhengende ned til pasientens skuldre og brysten (Figur 7). Pasientens hake skal ligge i nøytral stilling på haleskatten (Figur 7).

11. Mens den fremre delen av nakkekragen holdes i posisjon, legg nakkekragens bakre del omkring pasientens hode og nakke. Fest til slutt den bakre delen av nakkekragen til den fremre delen ved hjelp av bollen (Figur 8). Pass på å ikke berøre den bollen eller parallelt med bollen på et annet punkt (Figur 8).

12. Tilpass bollen etter behov. Det bør være å hode nakkekragen i haken på den fremre delen og etterstørrelsen bollen (Figur 9).

Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

6.1 Når pasienten ligger på ryggen, sjikk nakkekragen direkte under pasientens nakke.
6.2 Når pasienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke.

7. Garanti
1 år garanti i henhold til våre betingelser:
- gir en material- og produksjonsfeil på kjøpstid.
- gir en feil i forbindelse med kjøpsvillingen.

Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

2. Garanti
1 år garanti i henhold til vores garantibestemmelser:
- er gjeldende for materiale- eller fabrikkfeilstøtte på kabinettet.
- er kun gjeldende i forbindelse med fremrensning av kabinettvillingen.



da Dansk

1. Los modelos
REF: HMT11-EC-K
Popis výrobku: AEROresc® - EASY Collar Mini, regulovateľný krk s nastaviteľnou výškou pro batolata, děti a dospělí mládeži zvlášť, dle věku
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)
Popis výrobku: AEROresc® - EASY Collar Adult, regulovateľný krk s nastaviteľnou výškou pro dospělé, barva žlutá
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)

2. Anvendelse og beskrivelse
AEROresc® - Easy Collar er en effektiv, stabil cervikal linse. Målet er å posisjonere nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

3. Prinsipler for immobilisering
Som et forebyggende tiltak skal ryggens skade på nakkesøyle og ryggmargen holdes pasientens hode og kropp i en „nøytral stilling“, hodeløst eller ikke bevegelse seg fremover, bakover eller sidelengs. Den nøytrale stillingen forhindrer at skadede ryggvirvler eller fremmedlegemer penetrerer eller skader ryggmargen. I tillegg hindrer den nøytrale posisjonen lunge og/eller kompresjon av ryggmargen samt fysiske og/eller iskemiske skader.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

2. Når hode og nakke er stabilisert for hånd, bør en annen hjelper sette nakkekragen på pasienten. Som forsikret redningsmed, må størrelsen på nakkekragen tilpasses på forhånd. Den skal passe nakkekragen må ikke føre til overanstrengelse i pasientens nakke eller cervikalsøylen.

3. Mål avstanden mellom et tenk plan som går horisontalt rett under haken på pasienten, og et andre plan som går horisontalt rett over skuldrene (Figur 2).

4. Overfør den beregnede fingeravstanden på punkt 4.2, som vist på Figur 3, til målelinjen på nakkekragen og les av den korrekte størrelsen for nakkekragen på målelinjen (Figur 3).

5. Instillering av størrelse: AEROresc® - Easy Collar Adult er forholdsinstillingsstørrelse 1 „J“ „Neckless“ / AEROresc® - Easy Collar Mini er forholdsinstillingsstørrelse 1 „Infant“. Hvis det er behov for å ikke størrelsen på nakkekragen, leire sikkerhetstett ved å trekke i låseknappen (Figur 4).

6. Still inn riktig størrelse: Størrelsen „Neckless“ og „Tall“ på AEROresc® - Easy Collar Adult kan tilpasses i 16 løseinn. Størrelsen „Infant“ og „Small Adult“ på AEROresc® - Easy Collar Mini kan tilpasses 12 løseinn. Trekk nakkekragen fra hverandre til tillast størrelsen som vises i vinduet, stemmer med tallstørrelsen målt i punkt 4.4 (Figur 5).

7. Lås sikkerhetstett ved å trykke begge låseknappene ned (Figur 6).

8. Sett på nakkekragen

9. For å sette nakkekragen riktig på, trenes det 2 personer. Den første hjelperen skal opprettholde stabiliseringen og den andre posisjonen av hode og hals ved å gripe og holde i hode og nakke ved sprangene (Figur 1).

10. Den andre hjelperen skal styke den fremre delen av nakkekragen langs pasientens bryst og plassere haleskatten. Nakkekragen i sin helhet skal settes på eller påføres sammenhengende ned til pasientens skuldre og brysten (Figur 7). Pasientens hake skal ligge i nøytral stilling på haleskatten (Figur 7).

11. Mens den fremre delen av nakkekragen holdes i posisjon, legg nakkekragens bakre del omkring pasientens hode og nakke. Fest til slutt den bakre delen av nakkekragen til den fremre delen ved hjelp av bollen (Figur 8). Pass på å ikke berøre den bollen eller parallelt med bollen på et annet punkt (Figur 8).

12. Tilpass bollen etter behov. Det bør være å hode nakkekragen i haken på den fremre delen og etterstørrelsen bollen (Figur 9).


Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

6.1 Når pasienten ligger på ryggen, sjikk nakkekragen direkte under pasientens nakke.
6.2 Når pasienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke.

7. Garanti
1 år garanti i henhold til våre betingelser:
- gir en material- og produksjonsfeil på kjøpstid.
- gir en feil i forbindelse med kjøpsvillingen.

Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

2. Garanti
1 år garanti i henhold til vores garantibestemmelser:
- er gjeldende for materiale- eller fabrikkfeilstøtte på kabinettet.
- er kun gjeldende i forbindelse med fremrensning av kabinettvillingen.



MD



pl Polski

1. Model
REF: HMT11-EC-K
Opisowanie produktu: AEROresc® - EASY Collar Mini, regulowalny ortopedyczny walec stabilizacyjny kręgosłupa szyjnego, kolor niebieski
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)
Opisowanie produktu: AEROresc® - EASY Collar Adult, regulowalny ortopedyczny walec stabilizacyjny kręgosłupa szyjnego, kolor żółty
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)

2. Anvendelse og beskrivelse
AEROresc® - Easy Collar er en effektiv, stabil cervikal linse. Målet er å posisjonere nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

3. Prinsipler for immobilisering
Som et forebyggende tiltak skal ryggens skade på nakkesøyle og ryggmargen holdes pasientens hode og kropp i en „nøytral stilling“, hodeløst eller ikke bevegelse seg fremover, bakover eller sidelengs. Den nøytrale stillingen forhindrer at skadede ryggvirvler eller fremmedlegemer penetrerer eller skader ryggmargen. I tillegg hindrer den nøytrale posisjonen lunge og/eller kompresjon av ryggmargen samt fysiske og/eller iskemiske skader.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

2. Når hode og nakke er stabilisert for hånd, bør en annen hjelper sette nakkekragen på pasienten. Som forsikret redningsmed, må størrelsen på nakkekragen tilpasses på forhånd. Den skal passe nakkekragen må ikke føre til overanstrengelse i pasientens nakke eller cervikalsøylen.

3. Mål avstanden mellom et tenk plan som går horisontalt rett under haken på pasienten, og et andre plan som går horisontalt rett over skuldrene (Figur 2).

4. Overfør den beregnede fingeravstanden på punkt 4.2, som vist på Figur 3, til målelinjen på nakkekragen og les av den korrekte størrelsen for nakkekragen på målelinjen (Figur 3).

5. Instillering av størrelse: AEROresc® - Easy Collar Adult er forholdsinstillingsstørrelse 1 „J“ „Neckless“ / AEROresc® - Easy Collar Mini er forholdsinstillingsstørrelse 1 „Infant“. Hvis det er behov for å ikke størrelsen på nakkekragen, leire sikkerhetstett ved å trekke i låseknappen (Figur 4).

6. Still inn riktig størrelse: Størrelsen „Neckless“ og „Tall“ på AEROresc® - Easy Collar Adult kan tilpasses i 16 løseinn. Størrelsen „Infant“ og „Small Adult“ på AEROresc® - Easy Collar Mini kan tilpasses 12 løseinn. Trekk nakkekragen fra hverandre til tillast størrelsen som vises i vinduet, stemmer med tallstørrelsen målt i punkt 4.4 (Figur 5).

7. Lås sikkerhetstett ved å trykke begge låseknappene ned (Figur 6).

8. Sett på nakkekragen

9. For å sette nakkekragen riktig på, trenes det 2 personer. Den første hjelperen skal opprettholde stabiliseringen og den andre posisjonen av hode og hals ved å gripe og holde i hode og nakke ved sprangene (Figur 1).

10. Den andre hjelperen skal styke den fremre delen av nakkekragen langs pasientens bryst og plassere haleskatten. Nakkekragen i sin helhet skal settes på eller påføres sammenhengende ned til pasientens skuldre og brysten (Figur 7). Pasientens hake skal ligge i nøytral stilling på haleskatten (Figur 7).

11. Mens den fremre delen av nakkekragen holdes i posisjon, legg nakkekragens bakre del omkring pasientens hode og nakke. Fest til slutt den bakre delen av nakkekragen til den fremre delen ved hjelp av bollen (Figur 8). Pass på å ikke berøre den bollen eller parallelt med bollen på et annet punkt (Figur 8).

12. Tilpass bollen etter behov. Det bør være å hode nakkekragen i haken på den fremre delen og etterstørrelsen bollen (Figur 9).

Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

6.1 Når pasienten ligger på ryggen, sjikk nakkekragen direkte under pasientens nakke.
6.2 Når pasienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke. Når patienten ligger på ryggen, sett nakkekragen direkte under pasientens nakke.

7. Garanti
1 år garanti i henhold til våre betingelser:
- gir en material- og produksjonsfeil på kjøpstid.
- gir en feil i forbindelse med kjøpsvillingen.

Advarsel
Oppretthold en nøytral stilling av hode og nakke under hele prosedyren. Når nakkekragen er riktig satt og pasienten er immobilisert, skal hode ikke kunne beveges (Figur 13). Immobiliser i tillegg hode og nakke med hodestøtter eller en enhet for hodestøtte og fest pasienten med egnete festebelter på en bære eller bære med støtte for ryggryggen.

2. Garanti
1 år garanti i henhold til vores garantibestemmelser:
- er gjeldende for materiale- eller fabrikkfeilstøtte på kabinettet.
- er kun gjeldende i forbindelse med fremrensning av kabinettvillingen.



CE

ru Русский

1. Модели
REF: HMT11-EC-K
Описание продукции: AEROresc® - EASY Collar Mini, регулируемый ортезирователь шейного позвоночника, цвет синий
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)
Описание продукции: AEROresc® - EASY Collar Adult, регулируемый ортезирователь шейного позвоночника, цвет желтый
REF: HMT11-EC-E | HMT11-EC-T (Tactical)

2. Anvendelse og beskrivelse
AEROresc® - Easy Collar er en effektiv, stabil cervikal linse. Målet er å posisjonere nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

3. Prinsipler for immobilisering
Som et forebyggende tiltak skal ryggens skade på nakkesøyle og ryggmargen holdes pasientens hode og kropp i en „nøytral stilling“, hodeløst eller ikke bevegelse seg fremover, bakover eller sidelengs. Den nøytrale stillingen forhindrer at skadede ryggvirvler eller fremmedlegemer penetrerer eller skader ryggmargen. I tillegg hindrer den nøytrale posisjonen lunge og/eller kompresjon av ryggmargen samt fysiske og/eller iskemiske skader.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

Advarsel
Nakkesøyle og nakke manuell ved hjelp av en hjelper og hold det i nøytral posisjon (Figur 1).
Mer: Hvis du merker motstand eller pasientens problem ikke øker, følg de gjeldende retningslinjer for immobilisering av cervikalsøylen ved mistanke om eller brudd i nakken.

2. Når hode og nakke er stabilisert for hånd, bør en annen hjelper sette nakkekragen på pasienten. Som forsikret redningsmed, må størrelsen på nakkekragen tilpasses på forhånd. Den skal passe nakkekragen må ikke føre til overanstrengelse i pasientens nakke eller cervikalsøylen.

3. Mål avstanden mellom et tenk plan som går horisontalt rett under haken på pasienten, og et andre plan som går horisontalt rett over skuldrene (Figur 2).

4. Overfør den beregnede fingeravstanden på punkt 4.2, som vist på Figur 3, til målelinjen på nakkekragen og les av den korrekte størrelsen for nakkekragen på målelinjen (Figur 3).

5. Instillering av størrelse: AEROresc® - Easy Collar Adult er forholdsinstillingsstørrelse 1 „J“ „Neckless“ / AEROresc® - Easy Collar Mini er forholdsinstillingsstørrelse 1 „Infant“. Hvis det er behov for å ikke størrelsen på nakkekragen, leire sikkerhetstett ved å trekke i låseknappen (Figur